



Procura Generale della Repubblica di Potenza

Prot. n.
U.O.R.: SegrGen

All. /

Potenza,

Class. 1.2

Il Procuratore Generale

In data 7 aprile alle ore 10.25 sono presenti, presso l'ufficio del procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Potenza:

dr. Armando D'Alterio (P.g. Potenza);

dr. Francesco Curcio;

il sig. *OMISSIS* (responsabile del Gruppo di Protezione civile dell'associazione polizia di stato di Potenza;

il sig. *OMISSIS* (v. responsabile del Gruppo di Protezione civile dell'associazione Polizia di Stato di Potenza);

il sig. *OMISSIS*, responsabile del servizio di vigilanza del palazzo di giustizia di Potenza, via Nazario Sauro.

Richiesti di collaborazione ai fini del contrasto dell'emergenza Covid, dichiarano concordemente di conferire gratuitamente alla magistratura del distretto tre scanner; uno già consegnato al Tribunale di Matera, al cancelliere sig. *OMISSIS*

Due vengono consegnati oggi, unitamente ad un saturimetro.

Si dà atto che la strumentazione in argomento viene prelevata dal sig. *OMISSIS*, responsabile del servizio di vigilanza di questo palazzo di giustizia.

Richiesti di informazioni in merito, dichiarano che, per l'utilizzo degli stessi non occorre, né è prescritta qualifica particolare. Non sono strumenti invasivi. I

termoscanner ad infrarossi si utilizzano senza contatto con la persona. Chi li utilizza, anche eventualmente il personale di vigilanza, dovrebbe indossare una tuta protettiva integrale, comprensiva di guanti in lattice, che si reperiscono normalmente, che possiamo fornire nel numero di dieci, nonché lenti protettive, nel numero di sei, poiché il virus può propagarsi anche più velocemente tramite gli occhi.

Circa l'utilizzo, il soggetto sottoposto a controllo si pone di lato guardando in direzione opposta al soggetto che opera il rilievo, il quale a sua volta pone il rilevatore a distanza compresa fra cinque e dieci centimetri dalla fronte della persona, curando che il rilevatore sia ortogonale al cranio, ovvero parallelo al suolo.

Dichiarano altresì, richiesti sul punto, che, premesso che essi non hanno qualifica medica, né infermieristica, il protocollo cui il gruppo di appartenenza si attiene considera come valore, il cui superamento indica la sussistenza di uno stato febbrile, quello di 37 gradi; da 37.5 gradi in su si situa il discrimine che, secondo gli schemi attuali della Protezione civile nazionale viene preso in considerazione ai fini in argomento.

Preciso che, all'interno delle confezioni dei rilevatori, vi sono le istruzioni apposite.

Per quanto riguarda il rilievo tramite saturimetro, che si effettua attraverso l'inserimento in esso del dito indice, il valore normale varia dal minimo di 95 al massimo di 100.

Dichiarano di poter conferire in data odierna n. 10 tute in triatek, paia di occhiali protettivi in quanto immediatamente disponibili e cinque confezioni da 100 guanti l'una.

Il personale addetto alla verifica delle temperature dovrebbe utilizzare mascherine del tipo PF2 o PF3, cioè mascherine munite di valvola filtrante, monouso e non riutilizzabili al di là di un turno di servizio di 6-8 ore. Al di là di tale utilizzo, infatti, non danno più garanzia di protezione in quanto la sostanza chimica inserita nella valvola esaurisce la funzionalità attiva né sono lavabili, ma suscettibili solo di disinfezione dal lato esterno, a differenza di quelle di stoffa, che sono lavabili.

Ma, una volta lavate, quando hanno esaurito i tempi di utilizzo sopra indicati, le PF2 e le PF3 hanno una funzione protettiva analoga a quelle di stoffa.

Comunque quelle di stoffa non sono considerate né certificate come DPI; però consentono quotidianamente il lavaggio che ne consente il riutilizzo.

In mattinata consegniamo gratuitamente anche le 10 tute, da utilizzare con calzari appositi (che consegneremo in ugual numero quando disponibili e guanti in lattice).

Possiamo altresì conferire gratuitamente due maschere con filtri esterni, semi-maschere facciali TPE munite di due filtri P3 En 140. La durata delle stesse varia fra i 20 e 30 giorni, all'esito dei quali il filtro va cambiato. Vanno utilizzate sempre da un solo operatore, così come la mascherina individuale.

Il Sig. _____, in rappresentanza del servizio di vigilanza, si dichiara disponibile all'utilizzo di tali dispositivi, senza aggravio di spese, previo ordine di servizio dell'A.G.

Ulteriore cautela è costituita dalla circostanza che l'operatore a fine turno disinfezioni sia le lenti che i dispositivi di protezione, con sostanze a base alcolica. Gli occhiali vengono lavati con acqua calda e Lysoform. La mascherina con panno umido imbevuto di Bialcol.

Si dà atto che, nel corso della verbalizzazione, il dr. Curcio si allontana per concomitanti impegni.

Si acquisiscono in copia e si allegano al presente verbale le istruzioni allegate alle confezioni dei termoscanner e del saturimetro.

Alle ore 11.40 si dichiara chiuso il verbale.

OMISSIS

Il Procuratore Generale
Armando D'Alterio



Dott. Nicola Zuardi - Medico Competente
Ing. Vittorio Cerverizzo - RSPP

Spett.le
Procura Generale della Repubblica di
Potenza

Potenza, 09/04/2020

Oggetto: Presidi agli ingressi per controllo temperatura e saturazione, e test rapidi - Nota prot. 1969 del 09/04/2020.

A) In merito all'intenzione di installare, presso gli uffici giudiziari del Distretto, presidi con **termoscanner e saturimetri per il rilievo della temperatura corporea e della ossigenazione** per l'accesso negli uffici giudiziari di persone, si osserva quanto segue:

- il personale utilizzato dovrà essere opportunamente formato ed addestrato ricorrendo a personale infermieristico o addetti al primo soccorso; in alternativa o in mancanza degli stessi potrà essere utilizzato il personale addetto alla guardiana che dovrà essere necessariamente addestrato e formato.

- il personale impiegato nelle operazioni di controllo dovrà seguire la seguente procedura che oltre a definire il tipo di DPI da utilizzare, si propone di descrivere le varie fasi connesse all'uso degli stessi DPI, a come e quando indossarli, toglierli e smaltirli:

1. usare i seguenti DPI:

DPI	Norma di riferimento	Osservazioni
TUTA MONOUSO	EN 14605 - Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi; EN 14126 - Indumenti di protezione contro gli agenti infettivi	
GUANTI MONOUSO	Lattice - Nitrile - Neoprene- EN 374	<i>massimo livello anti-penetrazione e permeabilità - buona resistenza meccanica (strappo) - non adoperare guanti di gomma tipo domestico</i>
OCCHIALI PROTETTIVI	muniti di protezione laterale - a norma UNI EN 166	
MASCHERE FACCIALI FILTRANTI MONOUSO	norma tecnica UNI EN 149:2009 - filtri FFP3	Se si usa mascherina FFP3 con valvola filtrante, occorre sovrapporre alla stessa mascherina chirurgica per impedire il flusso di particelle sia in ingresso che in uscita
CALZARI MONOUSO		da indossare su scarpe in dotazione

2. Procedura di sicurezza - vestizione e svestizione:

- Individuare una zona atta alle operazioni di che trattasi, a sua volta individuando rispettivamente l'area di vestizione e quella di svestizione;



- Vestizione - rispettare la sequenza indicata: togliere ogni monile o oggetto personale, PRATICARE L'IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o soluzione alcolica; controllare l'integrità dei DPI, non utilizzare DPI non integri; indossare un paio di guanti; indossare, sopra la divisa in dotazione, il camice monouso; Indossare il facciale filtrante previsto (rif. tabella); indossare gli occhiali di protezione;

- durante le fasi di misurazione non vi dovranno essere contatti con persone in ingresso;

- Svestizione - rispettare la sequenza indicata: in caso di contatto con persona avente valori fuori norma e in caso di interruzione o di fine attività: evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute; i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore nell'area di svestizione; decontaminare i DPI riutilizzabili, ove previsto (soluzione a base di **ipoclorito di sodio -0.1% -0,5%**); rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore; rimuovere gli occhiali e sanificarli (soluzione a base di **ipoclorito di sodio -0.1% -0,5%**); rimuovere la maschera utilizzata FFP3 + eventuale mascherina chirurgica) maneggiandola/e dalla parte posteriore e/o dai lacci e smaltirla nel contenitore; rimuovere i guanti (prendere il bordo del primo e rivoltarlo - racchiudere il guanto rimosso nell'altra mano munita di guanto - infilare due dita della mano libera sotto il secondo guanto rivoltandolo in maniera da raccogliervi entrambi rivoltati senza contatti con la parte esterna - gettare nell'apposito contenitore); praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.

3. In merito alle fasi di svolgimento attività di misurazione, oltre a fare riferimento a quanto specificato nel protocollo condiviso COVID-19 in ambienti di lavoro del 14/03/2020, occorre seguire le seguenti procedure:

3.1 Modalità di prelievo temperatura:

- valori di riferimento: temperatura non superiore a 37,5 gradi;
- Modalità di controllo temperatura: il soggetto sottoposto a controllo della temperatura si pone di lato guardando in direzione opposta al soggetto che opera il rilievo, che a sua volta pone il rilevatore a distanza compresa fra 5 e 10 cm dalla fronte della persona, curando che il rilevatore sia ortogonale al cranio, ovvero parallelo al suolo;
 - se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota di cui al punto 2 del protocollo condiviso 14/03/2020 (privacy, trattamento dati personale, ecc.) - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

3.2 Rilievo della ossigenazione a mezzo saturimetro:

- saturazione non inferiore al 95 %;
- modalità di esecuzione: la misurazione dovrà essere fatta utilizzando il polpastrello del dito medio previa accurata disinfezione e pulizia con soluzioni disinfettanti a base alcolica o altro; accendere il saturimetro, inserire il polpastrello precedentemente disinfettato e attendere i risultati, dopo qualche secondo la parte superiore del display riporterà la saturazione del sangue e la parte inferiore riporterà la frequenza cardiaca.

4. Gestione dei rifiuti: I rifiuti devono essere messi in doppia busta e conferiti nell'indifferenziata.

B) In merito all'intenzione di effettuare, presso gli uffici giudiziari del Distretto, dei test rapidi, è consigliabile che vengano effettuati da personale altamente specializzato (medici o infermieri formati a tale compito). Gli stessi quindi non potranno essere effettuati dagli addetti al primo soccorso o dal personale addetto alla guardiania.

C) Durante le attività, rispettare le consolidate misure indicate nell'Allegato 1 al DPCM 08/03/2020.

Distinti saluti

Dott. Nicola Zuardi - Medico Competente



Ing. Vittorio Cerverizzo - RSPP





REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
DIREZIONE GENERALE
IL DIRIGENTE GENERALE

Viale Verrastro,9 - 85100 POTENZA
Tel. 0971.668755 - Fax 0971.668975
dg_sanita@regione.basilicata.it
sito ufficiale - www.regione.basilicata.it
PEC : sanita@cert.regione.basilicata.it

Potenza 14 aprile 2020

VISTO:

14/4/2020

Prot.n. IST 57580 /13A2

enza, li



Procuratore Generale
Armando D'Alterio

Al Procuratore Generale
Presso la Corte di Appello di Potenza
Dr. Armando D'Alterio
prot.pg.potenza@giustiziacert.it;
armando.dalterio@giustizia.it

Il Procuratore Generale
Armando D'Alterio

Codice PA 07606300709		
Procura Generale della Repubblica di Potenza		
UOR	CC	RUO
2003 14 APR. 2020		
Funzione	Microattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Al Presidente di Corte d'Appello di Potenza
Dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi
rosapatrizia.sinisi@giustizia.it;
ca.potenza@giustizia.it

TRASMISSIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA P.E.C.

(Valida a fini legali, DPR n.68 dell'11/2/2005, DLgs n.82 del 7/3/2005, "Codice dell'Amministrazione Digitale")

**Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 –
Attività di assistenza infermieristica.**

In riferimento all'oggetto si comunica che da giovedì 16/04/2020 inizierà l'attività di assistenza infermieristica presso il Tribunale di Potenza e di Lagonegro nell'ambito delle misure di contenimento contro il contagio da Covid-19.

A riguardo si evidenzia che saranno presenti 2 unità infermieristiche presso il Tribunale di Potenza a partire dalle ore 7:20 e pertanto si rende necessario prevedere almeno in questa fase iniziale di scarso afflusso di pubblico presso gli uffici giudiziari, soltanto n. 2 accessi. Anche per il Tribunale di Lagonegro sono previste n. 2 unità infermieristiche a partire dal giorno 16/04/2020 alle ore 7:20.

Si precisa che le due unità infermieristiche saranno dotate dei DPI necessari allo svolgimento della propria attività ed inoltre saranno dotati di termoscanner, test rapidi per rilevazione di antigeni e tamponi per test di conferma in caso di positività.

A tal fine si rende noto che considerata una predittività dei test rapidi non attendibile al 100% è indispensabile la sottoscrizione da parte dell'utente sottoposto a test di un consenso informato che sarà fornito dallo stesso infermiere.

Infine si provvederà a dotare di DPI anche il personale che sarà addetto alla rilevazione della temperatura come da VS richiesta.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Generale
Dr. Ernesto Esposito



Il Presidente della Corte d'Appello
Il Procuratore Generale della Repubblica
Distretto di Potenza

Prot. n. 2029
U.O.R.: SegrGen

All. 4

Potenza, 15 aprile 2020
Class. 1.2

Al Sig. Direttore Generale
del Dipartimento
politiche per la persona
Regione Basilicata
dr. Ernesto Esposito

Al Sig. Prefetto di Potenza
dr. Annunziato Vardè

Al Sig. Prefetto di Matera
dr. Rinaldo Argentieri

Al Sig. Questore di Potenza

Al Sig. Questore di Matera

Ai Comandanti Provinciali dei
Carabinieri
Potenza - Matera

Ai Comandanti Provinciali della
Guardia di finanza
Potenza - Matera

Ai Direttori delle Case circondariali
di Potenza e di Matera

Ai Presidenti dei Consigli
dell'Ordine del Distretto:

Avv. Maurizio Napolitano

Avv. Gherardo Cappelli

Avv. Ferdinando Izzo

Ai Capi degli Uffici del Distretto

Ai Dirigenti ed al Personale amministrativo
del Distretto

Al Magistrati della Procura Generale

Al Responsabile del Servizio
prevenzione e protezione
del Palazzo di Giustizia in Potenza
Ing. Vittorio Cerverizzo

Al Medico competente per il SPP
Dr. Nicola Zuardi

Al Responsabile del Servizio di Vigilanza
del Palazzo di Giustizia
svolto dalla "Cosmopol Basilicata srl"
in via Nazario Sauro n. 1
Sig. Domenico Bochicchio

E, p.c.:

Al Sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
dr. Giovanni Salvi

Alle Unità di crisi per l'emergenza Covid
presso la Settima Commissione CSM
e presso il Dipartimento
dell'Organizzazione giudiziaria
Ministero della Giustizia

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

Oggetto: Utilizzo di termoscanner e saturimetri per il rilievo della temperatura corporea; istituzione di un servizio di assistenza infermieristica (Rif.to V.S. nota 5.4.2020, prot.n.53687/13^o2 e riunione 2.4.2020) a supporto delle attività del Servizio di vigilanza del Palazzo di Giustizia in Potenza, via Nazario Sauro.

Lette le ordinanze del Presidente della Regione Basilicata nei termini di riferimento contenuti nell'ordinanza in data 11.4.2020, n.17;

- letto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 ed il DPCM 11 marzo 2020 ed in particolare l'art. 1, n. 7, lett. d), come richiamato da “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (del 14 marzo u.s., sottoscritto dalle organizzazioni sindacali su impulso della Presidenza del Consiglio e su concerto interministeriale);

- letto l'art. 2087 c.c. che, unitamente al D.Lgs. 81/2008, impone al datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale dei lavoratori;

- letto, in particolare, il citato protocollo per cui: “Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni”;

“Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, **e chi intende fare ingresso in azienda**, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS”;

- letto il **Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, co. 2 lett. h), k e l)**, che autorizza che l'accesso ai servizi pubblici essenziali sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;

- letto altresì il paragrafo 3 prot. cit., per cui l'accesso dei visitatori sottostà alle stesse regole;

- considerato che la rilevazione della temperatura corporea ed il rilievo tramite saturimetro costituiscono trattamento di dati personali e, pertanto, devono avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

- ritenuto che è possibile registrare l'identità dell'interessato ed il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso alla struttura; che deve essere fornita copia del presente alla persona cui viene inibito l'accesso, con registrazione dei dati identificativi, affinché acquisisca debita cognizione che il rilievo è fondato sui protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 mentre, con riferimento alla conservazione dei dati, la stessa è limitata al termine dello stato d'emergenza, con obbligo, a carico del responsabile del Servizio di Vigilanza, di annotare i dati in registro riservato, soggetto a custodia personale e divieto di trattamento degli stessi per finalità diverse dalla prevenzione

dal contagio da COVID-19 e di diffusione o comunicazione a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

con riferimento ai dipendenti dell'amministrazione e ad ogni ulteriore persona sottoposta al controllo, risultata positiva, saranno assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore o dell'utente. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore o l'utente comunichi di aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

vista la **circolare del Ministero della Salute in data 3/2/2020** che ha diffuso linee guida per la condotta degli operatori che, per ragioni professionali, si trovano a contatto con il pubblico, e le precauzioni da adottare nei luoghi di lavoro in relazione all'epidemia da Coronavirus (COVID-19);

viste le ulteriori Circolari del Ministero della Salute in materia di misure idonee ad affrontare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid 19) tra cui le circolari in data 22 febbraio e 18 marzo 2020;

richiamate le precedenti note e disposizioni degli scriventi volte a impartire indicazioni al personale di magistratura ed amministrativo in merito ai comportamenti da tenere per contenere la diffusione del contagio (disciplina orario apertura ufficio al pubblico e istituzione sportello dedicato) nonché i provvedimenti volti a dettagliare i limiti alla presenza in ufficio, in funzione della prevenzione del rischio connesso all'emergenza in atto;

visto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), predisposto dal Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), come aggiornato il 20.3.2020, ed il Protocollo governativo, condiviso con le parti sociali, inteso alla regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, allegato al DVR e le disposizioni esecutive emanate da questi Uffici;

tenuto conto della prescritta necessità di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea di tutte le persone che, a vario titolo, accedono quotidianamente a questo palazzo di giustizia (Via Nazario Sauro n. 1) ed al rilievo dei livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue;

acquisita la disponibilità del Responsabile del Servizio di Vigilanza della ditta Cosmopol presso questo Palazzo di giustizia all'utilizzo delle suddette apparecchiature, da parte del proprio personale, senza aggravio di spese per l'Ufficio;

considerato che, in data 7.4.2020, sono stati consegnati a detto personale di vigilanza dalla Protezione civile della regione Basilicata, due termoscanner ed un saturimetro unitamente a n. 10 tute, mascherine, occhiali protettivi e n. 500 guanti in lattice;

richiamate le pregresse disposizioni in materia di rispetto della distanza interpersonale, ed utilizzo di mascherine o dispositivi analoghi, emanate dagli scriventi ;

acquisito il consenso dei capi degli uffici siti in questo palazzo di giustizia ed informati i dirigenti amministrativi degli stessi, ai quali è stata consegnata la documentazione di riferimento;

DISPONGONO

1. La premessa è parte integrante delle presenti previsioni.

E' consentito l'accesso a questo Palazzo di Giustizia (via Nazario Sauro n. 21 , Potenza) da parte di chiunque sia autorizzato a farvi ingresso (personale amministrativo, magistrati, avvocati, Forze dell'Ordine, personale di vigilanza ed infermieristico ed ogni utente o fornitore) a condizione dell'intercorso rilievo della temperatura corporea, con termometro a raggi infrarossi a cura di personale infermieristico della Regione Basilicata, nei termini orari indicati dal Dirigente Generale del Dipartimento politiche della persona della Regione Basilicata e dunque dalle ore 7.20 fino alle ore 11.30, con le cautele indicate negli atti allegati al presente ed a cura di personale addetto alla vigilanza del palazzo in orari diversi, antecedenti o successivi a quelli sopra indicati, in ogni caso seguendo le indicazioni fornite da quest'ultimo e di cui alla documentazione allegata al presente atto.

2. Il rilievo della temperatura corporea avverrà all'accesso principale di questo palazzo di Giustizia. Pertanto, ogni altro accesso- in particolare tramite i locali di rimessaggio auto- sarà intercluso a cura del personale di vigilanza.
3. Espletato tale accertamento, potranno accedere unicamente coloro la cui temperatura corporea non superi i 37,5° C.
4. Ove tale livello della temperatura sia superato e dunque l'accesso non sia consentito, il personale sopra indicato proporrà all'interessato la verifica del livello di ossigenazione del sangue, tramite saturimetro; il personale infermieristico anche test rapido e rilievo tramite tampone in caso di esito positivo del test rapido, utilizzando allo scopo la sala Ortensia sita al p.t. del palazzo.
5. Nel richiedere il consenso dell'interessato verrà evidenziato che gli esiti negativi degli ulteriori accertamenti di cui sopra evitano l'obbligo di isolamento e di registrazione dei dati personali che consegue al superamento dei livelli di temperatura corporea.
6. Le persone cui sarà inibito l'accesso riceveranno copia del presente provvedimento, firmando per ricevuta sull'analogo documento che viene conservato dal personale di vigilanza ed allegato all'apposito registro; verranno in ogni caso invitate a porsi in


condizione di isolamento ed a contattare al più presto il medico curante ovvero le autorità sanitarie competenti;

7. I dati acquisiti verranno registrati, con l'annotazione delle generalità del soggetto interessato, solo nel caso in cui venga inibito l'accesso al palazzo di giustizia, al fine delle conseguenti comunicazioni alle autorità sanitarie competenti in funzione del contrasto dell'emergenza sanitaria;
8. I capi degli uffici degli altri palazzi di giustizia del Distretto sono vivamente pregati di valutare l'esigenza di adottare analoghe cautele.
9. La durata di questo provvedimento è allo stato fissata fino alla data dell'11 maggio 2020, salvo proroghe, anche alla luce della prima sperimentazione in atto dalla data di domani.


Si allegano:

- il verbale di audizione del personale della Protezione Civile della Basilicata in data 7.4.2020;
- la nota del Dirigente generale, Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata in data 14.4.2020;
- la nota in data 9.4.2020 a firma del Medico e del RSSP presso questo Palazzo di Giustizia.
- le istruzioni annesse ai dispositivi termoscanner e saturimetri.

Il Procuratore Generale
Armando D'Alterio

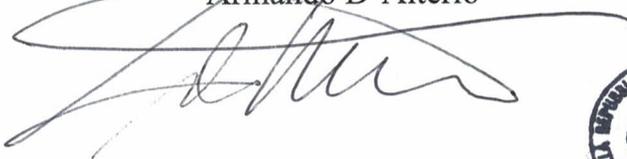

Il Presidente della Corte d'Appello
Rosa Patrizia Sinisi

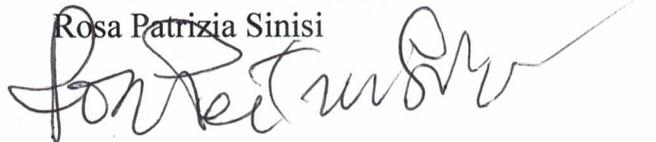

MC 602C

CE 022

**Pulsossimetro portatile da dito
Manuale d'uso**



REF 410703

Distribuito da

Ver. 3.0 Novembre 2018

Medi4Care Srl
Il Strada Zona Industriale
95032 Piano Tavola,
Belpasso (CT) ITALY
www.medi4care.com
2018 © Medi4Care Srl All rights reserved

Istruzioni per l'utente

Gentili utenti, grazie per aver acquistato un dispositivo della Medi4Care. Questo manuale è redatto in conformità con la Direttiva MDD93/42/CEE per i dispositivi medici e le Norme armonizzate.

Il manuale descrive, in base alle caratteristiche e ai requisiti del Pulsossimetro, struttura principale, funzioni, caratteristiche, metodi corretti per il trasporto, installazione, utilizzo, funzionamento, riparazione, manutenzione e conservazione, ecc., nonché le procedure di sicurezza per proteggere l'utente e il dispositivo. Fare riferimento ai rispettivi capitoli per i dettagli.

Si prega di leggere il manuale con molta attenzione prima di utilizzare il dispositivo. Queste istruzioni descrivono le procedure operative da seguire rigorosamente; la mancata osservanza di queste istruzioni può causare anomalie di misurazione, danni all'apparecchiatura e lesioni personali. Il produttore NON è responsabile per problemi di sicurezza, affidabilità, prestazioni e qualsiasi anomalia di monitoraggio, lesioni personali e danni alle apparecchiature a causa del mancato rispetto delle istruzioni d'uso. La garanzia del produttore non copre tali mancanze.

Questo prodotto è un Dispositivo Medico e può essere usato ripetutamente.

AVVERTENZE:

- Se si utilizza il dispositivo incessantemente potrebbe apparire una sensazione di disagio o di dolore. Si raccomanda di non applicare il sensore sullo stesso dito per più di 2 ore.
- L'utente deve prestare attenzione a dove posizionare il dispositivo. Non può essere posizionato sull'edema o su tessuto fragile.
- La luce (Infrarosso) emessa dal dispositivo è dannosa per gli occhi, quindi è consigliabile che l'utente e l'addetto alla manutenzione non fissino la luce.
- L'utente non può usare smalto per unghie o altro trucco.
- L'unghia dell'utente non può essere troppo lunga.
- Si prega di leggere attentamente il contenuto relativo alle restrizioni cliniche e alle precauzioni.
- Questo dispositivo non è da utilizzare per uso terapeutico.

1 Sicurezza

1.1 Avvertenze

- Controllare periodicamente il dispositivo e tutti gli accessori per accertarsi che non vi siano danni visibili su cavi e trasduttori che potrebbero influire sulla sicurezza del paziente e sul monitoraggio delle prestazioni. Si consiglia di ispezionare il dispositivo almeno una volta alla settimana. In presenza di un danno evidente non usare il dispositivo.
- La manutenzione necessaria deve essere eseguita ESCLUSIVAMENTE da tecnici qualificati.
- Il pulsossimetro non può essere utilizzato congiuntamente ad altri dispositivi non specificati in questo Manuale.
- Pericolo di esplosione: NON utilizzare il pulsossimetro in ambienti con gas infiammabili come alcuni agenti anestetici infiammabili.
- NON usare il pulsossimetro in un ambiente con RM o TC.
- In presenza di allergia alla gomma non usare il dispositivo.
- Lo smaltimento del dispositivo e dei relativi accessori ed imballaggi (compresi batteria, sacchetti di plastica, schiume e scatola di cartone) deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti locali.
- Si prega di controllare il contenuto della scatola prima dell'uso.

1.2 Attenzioni!

- Tenere il pulsossimetro lontano da polvere, vibrazioni, sostanze corrosive, materiali esplosivi, alte temperature e umidità.
- Se il pulsossimetro si bagna, si prega di smettere di usarlo.
- Quando viene trasportato da un ambiente freddo a un ambiente caldo o umido, si prega di non utilizzarlo immediatamente.
- NON azionare i tasti sul pannello frontale con materiali taglienti.
- Non è consentita la disinfezione del pulsossimetro ad alta temperatura o ad alta pressione. Consultare il Manuale nel relativo capitolo per le istruzioni di pulizia e disinfezione.
- Non immergere il pulsossimetro nel liquido. Quando è necessario, pulire la superficie con alcol medicale e asciugare con un panno morbido. Non spruzzare alcun liquido direttamente sul dispositivo.
- Quando si pulisce il dispositivo con acqua, la temperatura deve essere inferiore a 60°C.
- In presenza di dita troppo sottili o troppo fredde, caso che potrebbe influenzare la normale misurazione della SpO2 e della frequenza del polso dei pazienti, si prega di inserire il dito grosso, come il pollice o il medio, abbastanza profondamente nella sonda.
- Non utilizzare il dispositivo su pazienti neonati o bambini.
- Il prodotto è adatto a bambini di età superiore a quattro anni e adulti (il peso deve essere compreso tra 15 kg e 110 kg).
- Il dispositivo potrebbe non funzionare per tutti i pazienti. Se non si riesce a ottenere letture stabili, interrompere l'uso.
- Il periodo di aggiornamento dei dati è inferiore a 5 secondi ed è variabile in base alla diversa frequenza del polso individuale.
- Leggere il valore misurato solo quando l'onda pletismografica sullo schermo è stabile.
- Se durante la misurazione appaiono dati anomali sullo schermo, estrarre il dito e reinserirlo per ripristinare il normale utilizzo del dispositivo.
- Il dispositivo non ha la funzione allarme di batteria scarica, mostra solo che la carica è bassa. Si prega di cambiare la batteria quando la carica della stessa è bassa.
- Il dispositivo non ha funzioni di allarme. Non utilizzare il dispositivo in situazioni in cui sono richiesti allarmi.
- Le batterie devono essere rimosse se il dispositivo rimane inutilizzato per più di un mese.

2 Destinazione d'uso

MC 602C è in grado di monitorare la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e la frequenza cardiaca del paziente in maniera non invasiva sia a casa che in centri medici professionali. Si usa inserendo il dito, le cui dimensioni vanno da 0,8cm a 2,3cm, nell'apparecchio.

2.1 Classificazione:

Classe II a (MDD93/42/CEE)

2.2 Caratteristiche

- Il funzionamento del dispositivo è semplice ed intuitivo.
- Il dispositivo è piccolo, leggero (il peso totale è di circa 50g batterie incluse) e comodo da trasportare.
- Il consumo energetico del dispositivo è basso; le due batterie AAA possono essere utilizzate in maniera continuativa per 20 ore.
- Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 5 secondi di inutilizzo.

2.3 Principali applicazioni

Il pulsossimetro può essere utilizzato per misurare la saturazione dell'emoglobina e la frequenza del polso attraverso il dito e indicare l'intensità del polso tramite il display a barre.

Il prodotto non è adatto all'uso su pazienti che necessitano di un continuo monitoraggio.

Il dispositivo non è raccomandato per l'uso su pazienti che soffrono di tossici causata dal monossido di carbonio.

2.4 Requisiti ambientali

Ambiente di conservazione

- a) Temperatura: -40°C-+60°C
- b) Umidità relativa: ≤95%
- c) Pressione atmosferica: 500hPa-1060hPa

Ambiente operativo

- a) Temperatura: 10°C-40°C
- b) Umidità relativa: ≤75%
- c) Pressione atmosferica: 700hPa-1060hPa

3 Principi

3.1 Principio di misurazione

Il principio dell'Ossimetro utilizza la Legge di Lambert Beer in base alle Caratteristiche di assorbimento dello spettro dell'Emoglobina (Hb) e della Ossiemoglobina (HbO2) nelle zone luminose e vicino all'infrarosso. La Tecnologia di ispezione fotoelettrica dell'Ossiemoglobina viene usata congiuntamente alla Tecnologia di scansione a impulsi e registrazione di impulsi, in modo che due fasci di luci di diversa lunghezza d'onda possano essere concentrati sulla punta dell'unghia attraverso il sensore a morsetto.




Figura 1. Principio operativo

3.2 Attenzioni

1. Il dito deve essere posizionato correttamente (vedere Figura 5), altrimenti potrebbe causare misurazioni imprecise.
2. Il sensore SpO2 e il punto di ricezione fotoelettrico devono essere disposti in modo che l'arteriola del paziente si trovi in una posizione intermedia.
3. Il sensore SpO2 non deve essere usato in un punto o arto con costrittori del flusso sanguigno (ad esempio il bracciale per il rilevamento della pressione sanguigna); essi possono ostacolare le misurazioni.
4. Rimuovere qualsiasi oggetto che possa ostacolare le prestazioni del saturimetro.
5. Una luce eccessiva può influenzare il risultato della misurazione.
6. L'eccessivo movimento del paziente o l'interferenza elettrochirurgica possono influire sull'accuratezza delle misurazioni.

3.3 Restrizioni cliniche

1. Il saturimetro, per ottenere un valore accurato di SpO2, deve poter misurare le pulsazioni correttamente e quindi è necessario un buon flusso sanguigno. In tutti quei casi in cui il paziente presenta polso debole, bassa temperatura corporea o dell'ambiente, eccessivo sanguinamento o uso di farmaci vasocostrittori, l'onda pletismografica dell'SpO2 diminuirà e la misurazione sarà più difficile da determinare.
2. I coloranti intravascolari, l'emoglobina in monossido di carbonio (COHb), la metionina (Me+Hb), l'emoglobina tossicologica, possono influenzare l'accuratezza dell'PMC 602C.
3. I farmaci come la dopamina, la procaina, la prilocaina, la lidocaina e la butacaina possono determinare misurazioni errate della SpO2.

4 Specifiche tecniche

1. Display: Display LED

- Range SpO2: 0% - 100%
- Range Frequenza cardiaca: 30 bpm - 250 bpm
- Display: a Colonna ed a onda
- Alimentazione: 2 Batterie alcaline AAA×1.5V (oppure batteria ricaricabile). Range adattabile: 2.6V-3.6V
- Consumo energetico: Inferiore di 30mA.
- Risoluzione: 1% per SpO2 e 1 bpm per il battito.
- Precisione di misurazione: ± 2% nello stadio del 70%-100% di SpO2 e insignificante quando il livello è inferiore al 70% ± 2 bpm o ± 2% (selezionare più grande) per la frequenza cardiaca.
- Resistenza alla luce circostante: la variazione tra il valore misurato nella condizione di luce artificiale o naturale e quella della stanza buia è inferiore a ± 1%.
- L'ossimetro è dotato di un pulsante di accensione/spegnimento. Quando il dito non è inserito nel dispositivo esso si spegne automaticamente entro 5 secondi.
- Sensore ottico: Luce rossa (lunghezza d'onda 660 nm, 6,65 mW) - Infrarossi (lunghezza d'onda 880nm, 6.75mW)Red light (wavelength is 660nm, 6.65mW) - Infrared (wavelength is 880nm, 6.75mW)

5 Accessori

- > Laccio per il collo
- > 2 Batterie
- > Manuale d'uso

6 Installazione

6.1 Vista del pannello frontale

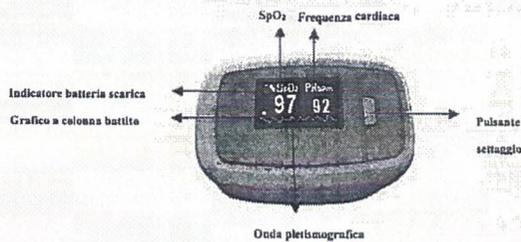


Figura 2. Vista frontale

6.2 Batterie

1. Vedi la Figura 3; inserire le 2 batterie AAA nel verso corretto.
2. Richiudere il coperchio.

Posizionare le batterie nel giusto verso per evitare di danneggiare il dispositivo.



Figura 3. Inserimento batterie

6.3 Montaggio del laccio per il trasporto al collo

1. Inserire una delle estremità del laccio nel foro.
2. Mettere l'altra estremità del laccio attraverso la prima e poi stringere.



Figura 4. Montaggio del laccio

6.4 Guida operativa

- 7.1 Inserire correttamente le due batterie e quindi riposizionare il coperchio.
- 7.2 Aprire la clip come mostrato nella Figura 5.



Figura 5. Inserimento dito

- 7.3 Posizionare il dito del paziente sui cuscinetti di gomma del fermaglio (assicurarsi che il dito sia nella posizione corretta), quindi far chiudere il dispositivo sul dito.
- 7.4 Premere il pulsante accensione sul pannello frontale.
- 7.5 Durante la misurazione non scuotere il dito e tenere il paziente a suo agio. Si raccomanda di minimizzare il movimento del soggetto per quanto possibile.
- 7.6 Rilevare i valori dal display del dispositivo.
- 7.7 Il pulsante ha tre funzioni. Quando il dispositivo è spento, premere il pulsante per accenderlo; quando il dispositivo è acceso, premendo brevemente il pulsante è possibile cambiare la direzione dello

schermo; Quando il dispositivo è acceso, premendo a lungo il pulsante è possibile modificare la luminosità dello schermo.

⚠ L'unghia e il tubo luminescente dovrebbero essere dallo stesso lato.

8 Manutenzione e Conservazione

- Sostituire la batteria quando sullo schermo appare il simbolo di carica batteria bassa.
- Pulire la superficie del dispositivo prima dell'uso. Pulire il dispositivo con alcool medicale, quindi lasciarlo asciugare all'aria o strofinarlo con un panno asciutto.
- Per prevenire eventuali infezioni disinfectare il prodotto con alcool medicale dopo ogni utilizzo.
- Estrarre le batterie se il pulsossimetro non viene utilizzato per un lungo periodo.
- L'ambiente ottimale di conservazione del dispositivo è - 40°C a 60°C di temperatura e un'umidità relativa non superiore al 95%.
- ⚠ Non sterilizzare il dispositivo in autoclave.
- ⚠ Non immergere il dispositivo in liquidi.
- ⚠ Conservare il dispositivo in un ambiente asciutto. L'umidità potrebbe danneggiarlo.

9 Risoluzione Problemi

Problema	Probabile Causa	Soluzione
Nessuna visualizzazione di SpO ₂ e frequenza cardiaca	1. Il dito non è inserito nel dispositivo correttamente. 2. SpO ₂ troppo basso per essere rilevato.	1. Posizionare il dito correttamente e riprovare. 2. Riprovare; se sei sicuro che il dispositivo funzioni correttamente recarsi in ospedale per una diagnosi.
SpO ₂ e frequenza del polso non vengono visualizzati in modo stabile	1. Il dito è posizionato in modo errato. 2. Il dito sta tremando o il paziente si sta muovendo.	1. Allineare il dito verso l'interno del dispositivo. 2. Mantenere il dito fermo e ridurre i movimenti del paziente.
Il dispositivo non si accende	1. Le batterie sono scariche o quasi scariche. 2. Le batterie non sono inserite correttamente. 3. Il malfunzionamento del dispositivo.	1. Sostituire le batterie. 2. Reinstallare le batterie. 3. Contattare il centro di assistenza locale.
Il display improvvisamente si spegne	1. Se il dito non viene rilevato o viene rimosso il dispositivo si spegnerà automaticamente entro 5 secondi. 2. Le batterie sono quasi scariche.	1. Normale. 2. Sostituire le batterie.

10 Descrizione dei Simboli

Simboli	Descrizione
	Tipo BF, non a prova di defibrillatore
	Leggere le istruzioni prima dell'uso
	Saturazione di ossigeno nel sangue (%)
	Frequenza cardiaca (battiti per minuto)
	Indicatore di batteria scarica
	Dito non inserito o segnale indeguito
	Elettrodo positivo della batteria
	Catodo della batteria
	1. Accensione 2. Cambia la direzione dello schermo 3. Cambia la luminosità dello schermo
	Senza allarme
	RAEE (2012/19/UE)
	Resistenza all'ingresso dei liquidi
	Attenzione, leggere attentamente le istruzioni
	Numero di lotto - Anno di produzione
	Marcatura CE

11 Specifiche tecniche

Informazioni Display	Modalità Display
Saturazione di Ossigeno (SpO ₂)	LED
Frequenza cardiaca (PR)	LED
Intensità battito (grafico a barre)	Display LED grafico a barre
Onda pleisimografica	LED
Parametri SpO₂	
Range di misurazione	0% - 100% (la risoluzione è 1%).
Precisione	70% - 100%: ±2%; Al di sotto del 70% non specificato.
Sensore ottico	Luce rossa (lunghezza d'onda 660nm) Infrarossi (lunghezza d'onda 880nm)
Parametri Pulsazioni	
Range di misurazione	30bpm - 250bpm (Risoluzione 1 bpm)
Precisione	±2bpm o ±2%
Intensità del polso	
Range	Grafico a barre continuo; più alta è la barra più alta è l'intensità dell'impulso
Sostituzione batterie	
Batterie alcaline 1.5V (tipo AAA) × 2 o Batterie ricaricabili	
Durata di utilizzo delle batterie	
20 ore di utilizzo continuativo	
Dimensioni e Peso	
Dimensioni	61 (Lunghezza) × 36 (Larghezza) × 32 (Altezza) mm
Peso	Circa 37g (incluso di batterie)

12 Condizioni di Garanzia

Congratulazioni per aver scelto un prodotto Medi4Care. Il prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi dalla data di fornitura. Durante il periodo di garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura. La garanzia decade in caso di riparazione effettuata da personale non autorizzato e/o ricambi non originali, urti o uso improprio, e se il numero di serie del dispositivo risulta rimosso o alterato. I prodotti difettosi devono essere resi, con il documento originale d'acquisto, esclusivamente al rivenditore che ha effettuato la vendita.

Appendice

Tabelle EMC - Dichiarazione di Immunità Elettromagnetica

Tabella 1. Emissioni Elettromagnetiche		
Il Dispositivo MC 602C è previsto per funzionare nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l'utilizzatore dovrebbero garantire che esso venga impiegato in tale ambiente.		
Prova di emissione	Conformità	Ambiente elettromagnetico
RF emissions CISPR II	Gruppo I	Il Dispositivo MC602 utilizza energia RF solo per il suo funzionamento interno. Perciò le sue emissioni RF sono molto basse e verosimilmente non causano interferenze negli apparecchi elettronici vicini.
RF emissions EN55011 Emissioni Armoniche IEC 61000-3-2	Classe B Non applicabile	E' possibile utilizzare l'apparecchio in tutti gli edifici, compresi gli edifici domestici, e quelli direttamente collegati alla rete di alimentazione pubblica in bassa tensione che alimenta edifici per usi domestici.
Fluttuazioni di tensione/ Flicker IEC 61000-3-3	Non applicabile	

Tabella 2. Immunità Elettromagnetica			
Il Dispositivo MC 602C è previsto per funzionare nell'ambiente elettromagnetico sotto specificato. Il cliente o l'utilizzatore dovrebbero garantire che esso venga impiegato in tale ambiente.			
Prova di immunità	Livello di prova EN 60601-1-2	Livello di conformità	
Scariche elettrostatiche (ESD) EN 61000-4-2	± 6kV a contatto ± 8kV in aria	± 6kV a contatto ± 8kV in aria	I pavimenti devono essere in legno, calcestruzzo o in ceramica. Se i pavimenti sono ricoperti di materiale sintetico, l'umidità relativa dovrebbe essere almeno del 30 %.
Transitori/irradiamenti elettrici veloci IEC 61000-4-4	±2kV per linee di alimentazione ±1kV per linee I/O	Non Applicabile	
Sovertensioni IEC 61000-4-5	±1 kV modo differenziale ±2 kV modo comune	Non Applicabile	
Campo magnetico alla frequenza di rete EN 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	La qualità della tensione di rete dovrebbe essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
RF Condotta IEC 61000-4-6	3 Veff da 150kHz a 80MHz	3 Veff da 150kHz a 80MHz	Gli apparecchi di comunicazione a RF portatili e mobili non dovrebbero essere usati vicino a nessuna parte dell'apparecchio, compresi i cavi, eccetto quando rispettano le distanze di separazione raccomandate calcolate dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanze di separazione raccomandate d = 1,2 √P da 150kHz a 80MHz d = 1,2 √P da 80 MHz a 800 MHz d = 2,3 √P da 800 MHz a 2,5 GHz ove P è la potenza massima nominale d'uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore e d è la distanza di separazione raccomandata in metri (m).
RF Radiata IEC 61000-4-3	3 Veff da 80MHz a 2.5GHz	3 Veff da 80MHz a 2.5GHz	L'intensità del campo dei trasmettitori a RF fissi, come determinato in un'indagine elettromagnetica del sito, potrebbe essere minore del livello di conformità in ciascun intervallo di frequenza. Si può verificare interferenza in prossimità di apparecchi contrassegnati dal seguente simbolo:

Tabella 3. Distanza di separazione raccomandata tra gli apparecchi di radiocomunicazione portatili e mobili e l'apparecchio MC 602C

Il Dispositivo MC 602C è previsto per funzionare in un ambiente elettromagnetico in cui sono sotto controllo i disturbi irradiati RF. Il cliente o l'operatore dell'apparecchio possono contribuire a prevenire interferenze elettromagnetiche assicurando una distanza minima fra gli apparecchi di comunicazione mobili e portatili a RF (trasmettitori) e l'apparecchio, come sotto raccomandato, in relazione alla potenza di uscita massima degli apparecchi di radiocomunicazione.

Potenza di uscita nominale massima del trasmettitore (W)	Distanza di separazione alla frequenza del trasmettitore (m)		
	Da 150kHz a 80MHz d = 1,2 √P	Da 80MHz a 800MHz d = 1,2 √P	Da 800MHz a 2GHz d = 2,3 √P
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Per i trasmettitori con potenza nominale massima di uscita sopra non riportata, la distanza di separazione raccomandata d in metri (m) può essere calcolata usando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, ove P è la potenza massima nominale d'uscita del trasmettitore in Watt (W) secondo il costruttore del trasmettitore.

- Nota:
(1) A 80 MHz e 800 MHz si applica l'intervallo della frequenza più alta
(2) Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

Contec Medical Systems Co., Ltd.
Add: No.112 Qinhuang West Street, Economic & Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC REPRESENTATIVE
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

